


▲ 向上/運動醫學中心-設備一批-規格書 ▲

項次	規格說明	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)
A、史密斯無重力訓練機(含槓片+20kg槓鈴+小飛鳥)*1組			
1.	尺寸：長130*寬200*高210cm	標配	
2.	框架主體含配件：J鉤*1對、保護槓*1對、置槓片桿*6支、置槓勾*1個	標配	
3.	固定桿*1支	標配	
4.	滑輪配重-雙側：每一側配重塊總重92.25kg 滑輪配重-高低拉後側：4.5kg*20片、2.25kg*1片	標配	
5.	高低拉專屬輔助：腿部靠墊 1套	標配	
6.	Cable訓練手把：V型划船把*1件、寬握拉桿*1件、360°飛鳥把手*1對	標配	
7.	可調式臥推椅*1張	標配	
8.	競技彩色PU槓片(5,10,15,20,25kg各1對)*1組	標配	
9.	自由重訓專用槓鈴【20kg男槓】*1支	標配	


請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明其佐證出處或寫出差異處，謝謝

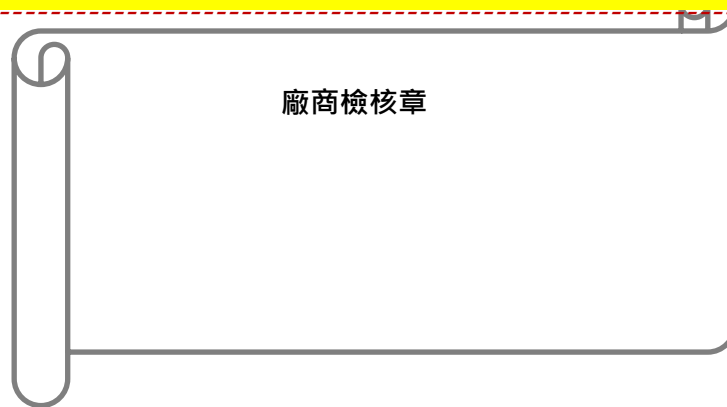

▲ 向上/運動醫學中心-設備一批-規格書 ▲

項次	規格說明	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)
B、懸吊運動治療系統工作站(含施工)*2			
一、懸吊主機*3			
1.	材質:塑鋼一體成型	標配	
2.	尺寸:64x20x7 公分	標配	
3.	繩索:直徑8釐米,長5公尺附圈形握繩,	標配	
4.	可無段調整長度、主繩含掛勾、吊帶含環	標配	
二、核心轉軸主機*1			
1.	材質:塑鋼一體成型 尺寸:51x7x3 公分	標配	
2.	繩索:直徑8釐米,長5公尺附圈形握繩,	標配	
3.	可無段調整長度主繩含掛勾	標配	
配件:			
1.	握把式懸吊帶	1組	
2.	懸吊治療帶含環	2條	
3.	腰背懸吊帶含扣環	2條	
4.	頸部懸吊帶含扣環	1條	
5.	治療繩含止滑扣及環扣/60cm	2條	
6.	治療繩含止滑扣及環扣/30cm	2條	
7.	彈性治療繩含止滑扣及掛勾/30cm /黑/低阻力	2條	
8.	彈性治療繩含止滑扣及掛勾/30cm /紅/高阻力	2條	
9.	彈性治療繩含止滑扣及掛勾/60cm/紅/高阻力	2條	
10.	彈性治療繩含止滑扣及掛勾/60cm/黑/低阻力	2條	
11.	叉形固定片	1個	
12.	牆上固定放置架	2個	
13.	五公尺懸吊繩(紅色)	1條	
14.	多用途平衡墊	2個	
15.	滾筒	1個	
16.	操作手冊	1本	
三、滑動懸吊軌道*1			
1.	雙軌道滑軌附煞車裝置	標配	
2.	材質:鋼材與鋁合金	標配	
3.	尺寸:180x76x15 公分±5%	標配	


請確認上表規格之廠商檢核欄位, 皆有標明其佐證出處或寫出差異處, 謝謝

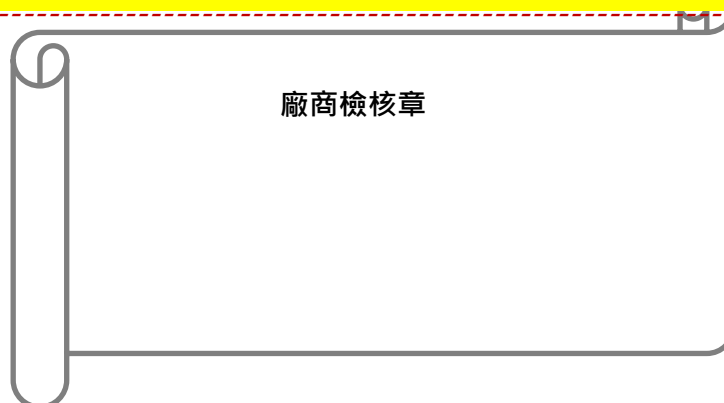

▲ 向上/運動醫學中心-設備一批-規格書 ▲

項次	規格說明	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)
C、徒手操作電動三片物理治療床*2			
1.	L195*W70*H46-91cm(升降高度基準)	標配	
2.	電動式升降	標配	
3.	承重220kg以上	標配	
4.	4個角度的床腳皆可調校高低	標配	
5.	4個可鎖定腳輪	標配	


請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明其佐證出處或寫出差異處，謝謝

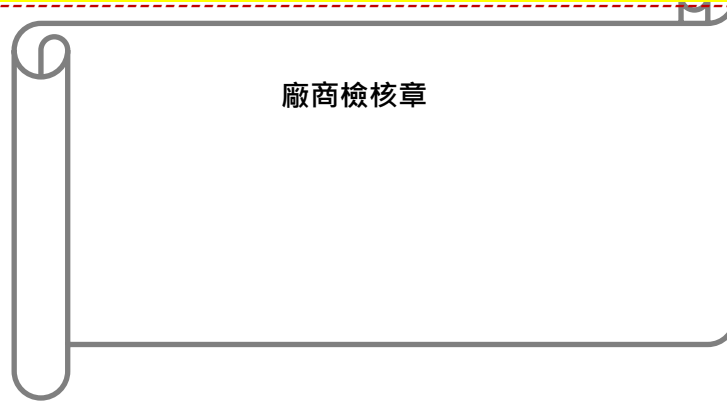

▲ 向上/運動醫學中心-設備一批-規格書 ▲

項次	規格說明	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)
D、血液阻斷訓練/Blood Flow Restriction Training*2			
1.	專用壓脈帶式綁帶*3條 (尺寸基準：18*4.5英寸*1、24*4.5英寸*1、34*4.5英寸*1)	標配	
2.	專用主機	標配	
3.	專用連接管*1條	標配	
4.	專用布套*3個	標配	
5.	壓力範圍：50-350mmHg, 以1mmHg的增量可調，自動調節至所選壓力的+/-10mmHg	標配	
6.	壓力應用計時器：1-30分鐘，每次調整以1分鐘增減	標配	

請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明其佐證出處或寫出差異處，謝謝

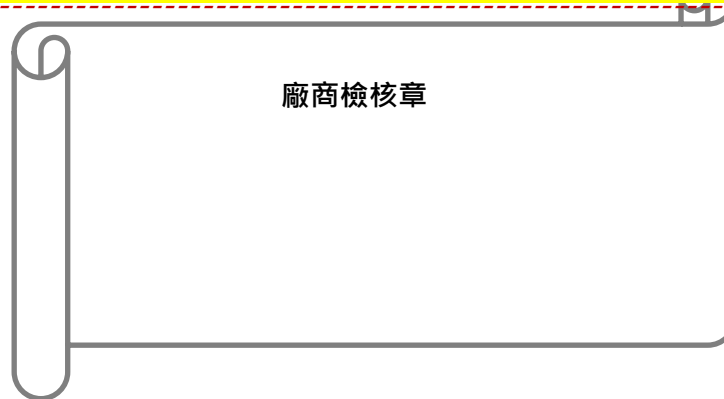

▲ 向上/運動醫學中心-設備一批-規格書 ▲

項次	規格說明	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)
E、臥式健身車			
1.	面板設計：LED	標配	
2.	顯示資訊：騎車時間、速度、心跳值、卡路里、距離	標配	
3.	阻力訓練：8段以上手調阻力	標配	
4.	運動程式：6種以上運動模式	標配	
5.	電源方式：110V	標配	
6.	乘載重量：100kg以上	標配	

請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明其佐證出處或寫出差異處，謝謝

