

向上/檢驗科-血庫專用變頻冷凍櫃 規格表

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 標示佐證出處 或 寫出差異
功能規格：		
1	溫度範圍:-15°C~-35°C · 出廠設定-30°C	
2	容量：650公升	
3	外門：實心單門設計 · 附門鎖	
4	層架：7個不銹鋼血袋專用抽屜式層架	
5	具自動除霜功能	
6	電壓：110V/60Hz	
7	使用符合未來2025年後環保法規的碳氫(HC)冷媒	
8	使用全碳氫冷媒之變頻壓縮機，符合國際SNAP(蒙特婁公約要求)，並具V-Drive控溫技術，可依照及時溫度與設定溫度差異決定運轉功率以達開關門後快速降溫與日常節能間之平衡，在日常溫度穩定情況下讓壓縮機以降載功率運作，減少耗電量及延長壓縮機壽命，比以往更省電、靜音	
9	擁有國際EnergyStar能源之星節能標章認證微電腦數位控制面板顯示溫度，可上鎖設計避免設定變更	
10	微電腦警報控制系統，具有高、低溫警報，門未關閉，電源失效，電力蓄電不足等警報功能。內建自動充電電池，若斷電時仍可維持面板、監測系統之運作	
11	內部風扇循環，溫度回復快，均一性佳	
12	電子控制感應器溫度警報測試功能	
13	可拆洗的空氣濾網，避免灰塵累積在冷凝器上	
14	符合GMPCleanRoomClassA/ISO6(ISOEN14644-1)，cUL，及具備國內衛署一級許可證明	
15	產品符合國際 AABB法規之要求	
16	溫度感測器型式:StandardRTD(等同PT1000)，主機內建溫度感測器用以做各種必要參數控制，以達精確控溫與運作平衡	
17	低噪音表現	
18	標準原廠配備七日型圓盤溫度記錄器	

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：_____

向上/檢驗科-三門冷藏冰箱 規格表

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 標示佐證出處 或 寫出差異
功能規格：		
1	使用溫度：0°C ~ 10°C；電源：110V/60HZ。	
2	外覆材質：鍍鋅粉體烤漆鋼板。	
3	保溫材質：環保高密度發泡劑。	
4	散熱系統：風扇輔助散熱式冷凝器。	
5	主機：SECOP壓縮機；R134a環保冷媒。	
6	控制系統：全自動溫度含攝氏溫度顯示調控器。	
7	除霜系統：因應特定環境可控制每日除霜及時間週期；出廠設定：4小時除霜15分鐘。	
8	壓縮機延遲啟動保護裝置，出廠設定：送電後 1 分鐘啟動。	
9	庫內溫度可校正設置。	
10	具有高低溫警報功。	
11	停機後再啟動的溫度差可調整。	
12	本機具節能式熱冷媒管防潮系統，採用零耗能熱銅管式自動防潮邊框。	
13	各項參數碼具鎖定功能，避免勿觸而影響正常運轉。	
14	使用冷藏專用內燈。	
15	低溫專用鋼架外覆熱塑性塑料PVC置物層架15層。	
16	具有電源、燈光、除霧指示燈及開關，含高低溫警報。	
17	使用節能自動運轉除霧保溫複層玻璃。	
18	尺寸:W1880*D850*H2070 MM。	
19	淨容量：1455L。	


●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：_____

▲ 向上院區-病理科+檢驗科-雙門冷藏冰箱*2-規格書 ▲

項次	規格說明	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)
1-1	使用溫度：0°C ~ 10°C；電源：110V/60HZ。	標配	
1-2	外覆材質：鍍鋅粉體烤漆鋼板。	標配	
1-3	保溫材質：環保高密度發泡劑。	標配	
1-4	散熱系統：風扇輔助散熱式冷凝器。	標配	
1-5	主機：SECOP壓縮機；R134a環保冷媒。	標配	
1-6	控制系統：全自動溫度含攝氏溫度顯示調控器。	標配	
1-7	除霜系統：因應特定環境可控制每日除霜及時間週期； 出廠設定：4小時除霜15分鐘	標配	
1-8	壓縮機延遲啟動保護裝置，出廠設定：送電後1分鐘啟動。	標配	
1-9	庫內溫度可校正設置。	標配	
1-10	停機後再啟動的溫度差可調整。	標配	
1-11	本機具節能式熱冷媒管防潮系統，採用零耗能熱銅管式自動防潮邊框。	標配	
1-12	各項參數碼具鎖定功能，避免勿觸而影響正常運轉。	標配	
1-13	使用冷藏專用內燈。	標配	
1-14	低溫專用鋼架外覆熱塑性塑料PVC置物層架 5層/門。	標配	
1-15	具有電源、燈光、除霧指示燈及開關，含高低溫警報功能。	標配	
1-16	使用節能自動運轉除霧保溫複層玻璃。	標配	
1-17	尺寸：W1260*D850*H2070mm。	標配	
1-18	淨容量：970L。	標配	

請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明其佐證出處或寫出差異處，謝謝

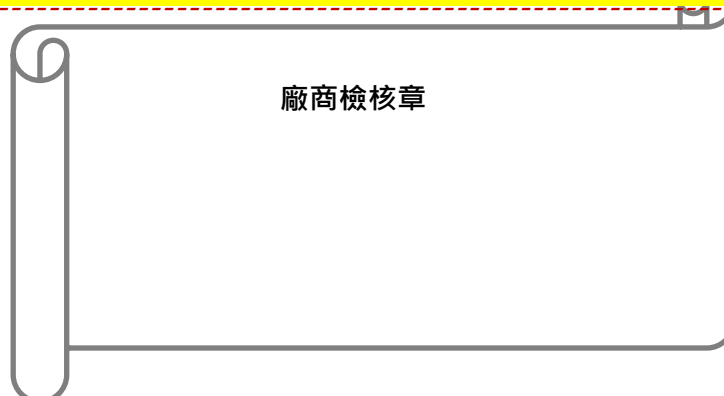


廠商檢核章

▲ 向上院區/檢驗科-(血庫)單門冷藏冰箱-規格書 ▲

項次	規格說明	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)
1-1	溫度範圍:1~6°C, 原廠設定:4°C	標配	
1-2	容量:650公升	標配	
1-3	外門:具安全玻璃單門設計,附門鎖	標配	
1-4	層架:7個不銹鋼血袋專用抽屜式層架(可自行任意調整)	標配	
1-5	具自動除霜功能	標配	
1-6	電壓:110V/60Hz	標配	
1-7	使用符合未來2025年後環保法規的碳氫(HC)冷媒	標配	
1-8	使用全碳氫冷媒之變頻壓縮機,符合國際SNAP(蒙特婁公約要求),並具V-Drive控溫技術,可依照及時溫度與設定溫度差異決定運轉功率以達開關門後快速降溫與日常節能間之平衡,在日常溫度穩定情況下讓壓縮機以降載功率運作,減少耗電量及延長壓縮機壽命,比以往更省電、靜音	標配	
1-9	擁有國際Energy star能源之星節能標章認證	標配	
1-10	微電腦控制面板,LED數字顯示溫度,具10項設定/警示功能顯示(溫度顯示,溫度警報,斷電警報,維修警示,增加鍵,門未關閉警示,電池不足警示,遞減鍵,掃描警示,聲響警報)	標配	
1-11	安全設定:三段位置,用鎖可以啟動主電源及警報器;鎖定溫度和警報設定點,減少設定點之錯誤和防止干擾	標配	
1-12	內部風扇循環,溫度回復快,均一性佳	標配	
1-13	具門開時警示亮燈之裝置,開門過久時,自動閃燈及聲響警示並具高低溫警報測試設定功能	標配	
1-14	具門未緊閉、維修要求、供電中斷、電池不足之圖示警示功能	標配	
1-15	產品符合國際AABB法規之要求	標配	
1-16	LED低熱度內部照明,附獨立開關	標配	
1-17	符合FDA listed Class II Medical Device, 510K exempt之規範、及行政院衛生署第一等級醫療器材許可證	標配	
1-18	標準原廠配備七日型圓盤溫度記錄器	標配	

請確認上表規格之廠商檢核欄位,皆有標明其佐證出處或寫出差異處,謝謝

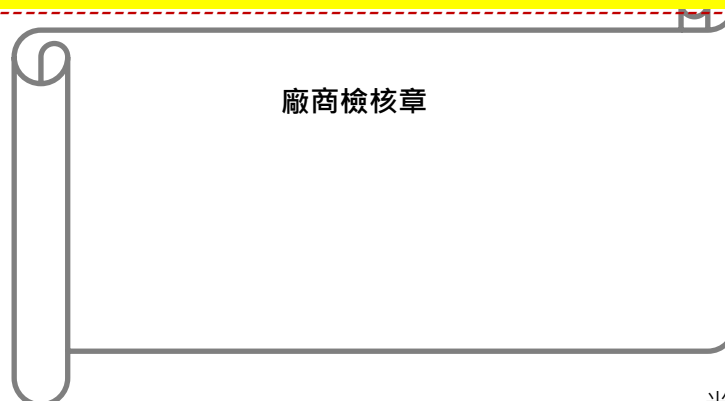

光田醫院向上院區感染管制室-單門直立式冷藏櫃*1

項目名稱及規格說明

廠商檢核
(標示佐證出處
或寫出差異)

單門直立式冷藏櫃規格：

- 1.使用溫度：2°C~8°C。
- 2.電源：110V 1Φ60HZ。
- 3.外覆材質：鍍鋅粉體烤漆鋼板。
- 4.保溫材質：環保高密度發泡劑。
- 5.低耗能免保養式散熱系統：風扇輔助免保養鐵絲式冷凝器，免清散熱。
- 6.冷媒系統：R134a 環保冷媒。
- 7.控制系統：全自動溫度含攝氏溫度顯示調控器。
- 8.壓縮機延遲啟動保護裝置，出廠設定：送電後1分鐘啟動。
- 9.自動除霜氣冷式，除霜週期可獨立控制。
- 10.庫內溫度可校正設置。
- 11.停機後再啟動的溫度差可調整。
- 12.本機具節能式熱冷媒管防潮系統，採用零耗能熱銅管式自動防潮邊框。
- 13.各項參數碼具鎖定功能，避免勿觸而影響正常運轉。
- 14.使用冷藏專用內燈。
- 15.低溫專用鋼架外覆熱塑性塑料PE置物層架，層架4層。
- 16.具有電源、燈光、除霧指示燈及開關，含內建高低溫警報。
- 17.使用節能自動運轉除霧保溫複層玻璃。
- 18.尺寸：W600*D685*H1590MM。
- 19.淨容量：360L。
- 20.全機保固兩年(天災人禍，機台散熱不良及消耗品除外)。

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：
