


▲ 向上院區-產房-LDR產檯床*1-規格書 ▲

序	規格說明	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)	
			頁	差異處
一、床體				
1	尺寸： 床體至少190X90cm(含)以上、高度至少45~100cm(含)以上	標配		
2	床墊：必須具備透氣、抗菌功能。 頭部的床墊高度為13公分±5%，床尾的床墊高度為9公分±5%。 生產時腳部床墊易於取下	標配		
3	床面升降高度： 1. 頭部上升角度：63°±5% 2. 床座臀部可上升角度：0°~25° 3. 床身前後傾斜角度：8°±5% 4. 背板傾斜角度：-10°~60°電液壓系統。 5. 腿支撐開合角度：左,右0°~33°電動馬達驅動。 6. 腳後跟彎曲角度：43°~47° 手動或電動控制角度。 7. 輔助台旋轉角度：90°手動或電動控制角度。 8. 已旋轉背板之滑動：60mm手動或電動控制角度。 9. 床邊護欄旋轉角度：180°手動或電動控制角度。 10. 腿支撐器彎曲角度：73°~77°手動或電動控制角度。 11. 輔助台滑動角度：150mm手動或電動控制角度。 12. 電源需求AC110V	標配		
4	承重重量：全床：220公斤±5%、床尾部：181公斤±5%。	標配		
5	床輪：床體兩側各有踩踏控制器一組、 必須具備中央式輪鎖固定煞車。	標配		
6	具床欄設計以利於孕婦安全	標配		
7	生產腳架兩個於床尾部位或床尾部分可分開以便生產	標配		
8	電動及備用蓄電功能，電動操控模式，至少需具備三個可電動操控床身 頭部、膝部及床體升降之功能。	標配		
11	需具備 CPR 控制釋放桿(左右各一組)並有明顯標示。	標配		
二、配件				
1	腳踏開關	1組		
2	手動開關	1個		
3	枕頭	1個		

▲ 向上院區-產房-LDR產檯床*1-規格書 ▲

序	規格說明	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)	
			頁	差異處
4	電源線	1個		
5	汗水盤	1個		
6	點滴架	1支		
7	床墊	1組		
8	分娩握桿	1個		
9	床頭板	1個		
10	(選配) 床上桌 尺寸: 寬48*長95cm*高度可調: 74~117 cm	1個		
11	(選配) 床頭櫃 尺寸: 長43*寬53*高80cm	1個		
12	(選配) 處理車 尺寸: 長40*寬40*高88.5cm	1個		

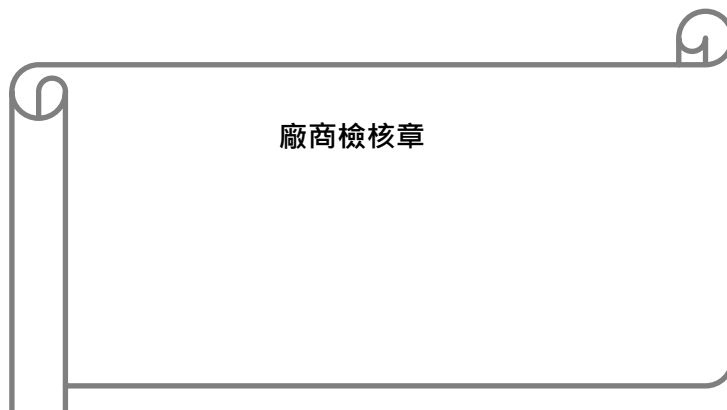

請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明其佐證出處或寫出差異處，謝謝